



Záložní zdroj (rezervní)

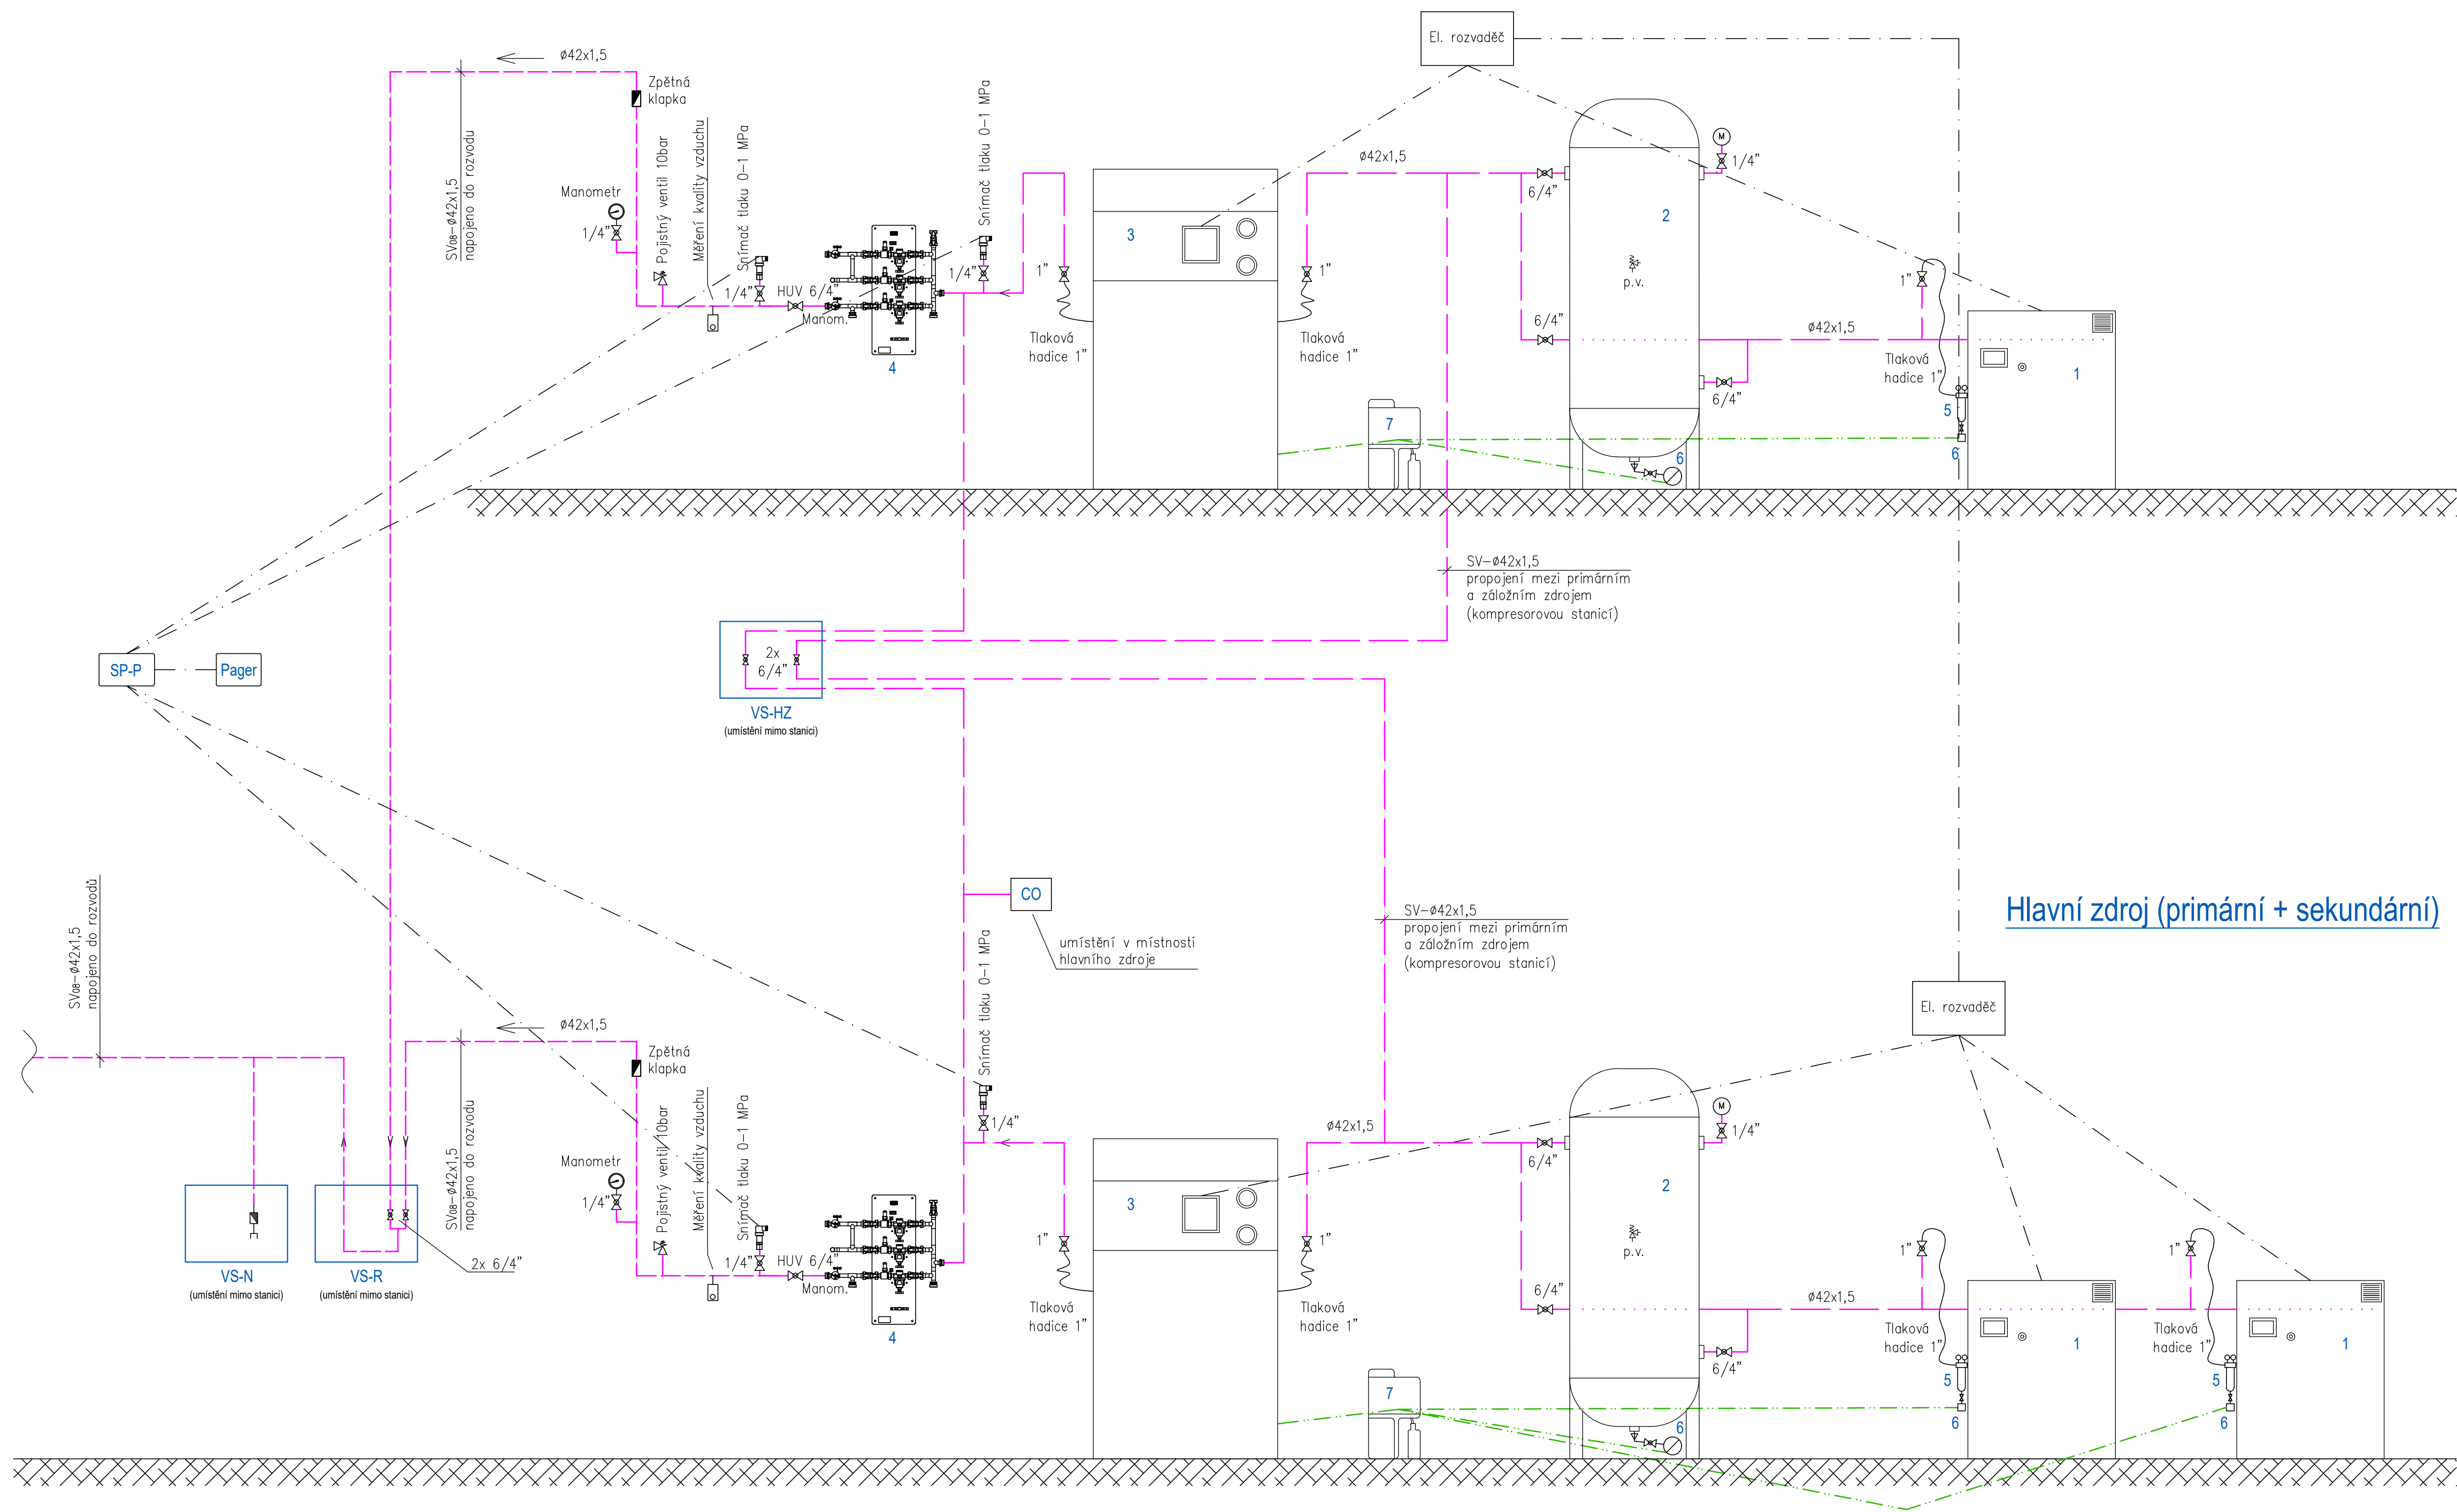

Kompressorová stanice - legenda	
1	Kompressor šroubový, výkon 91 m ³ /h při 10 bar
2	Vzdušník, objem 1000 litrů
3	Jednotka čištění vzduchu, výkon 121 m ³ /h
4	Redukční řada, dvojtlak z 10/8 bar
5	olejový filtr
6	Automatický odvoděč kondenzátu
7	Separátor oleje

- LEGENDA:
- Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro pohon nástrojů (SVa)
 - Odvod kondenzátu
 - El. propojení
 - NOVE KONSTRUKCE — PŘÍČKY
 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY
- Pager
SP-P
- Telekomunikační zařízení (provozní signalizace)
Signalizační panel provozního nouzového alarmu

Hlavní zdroj (primární + sekundární)

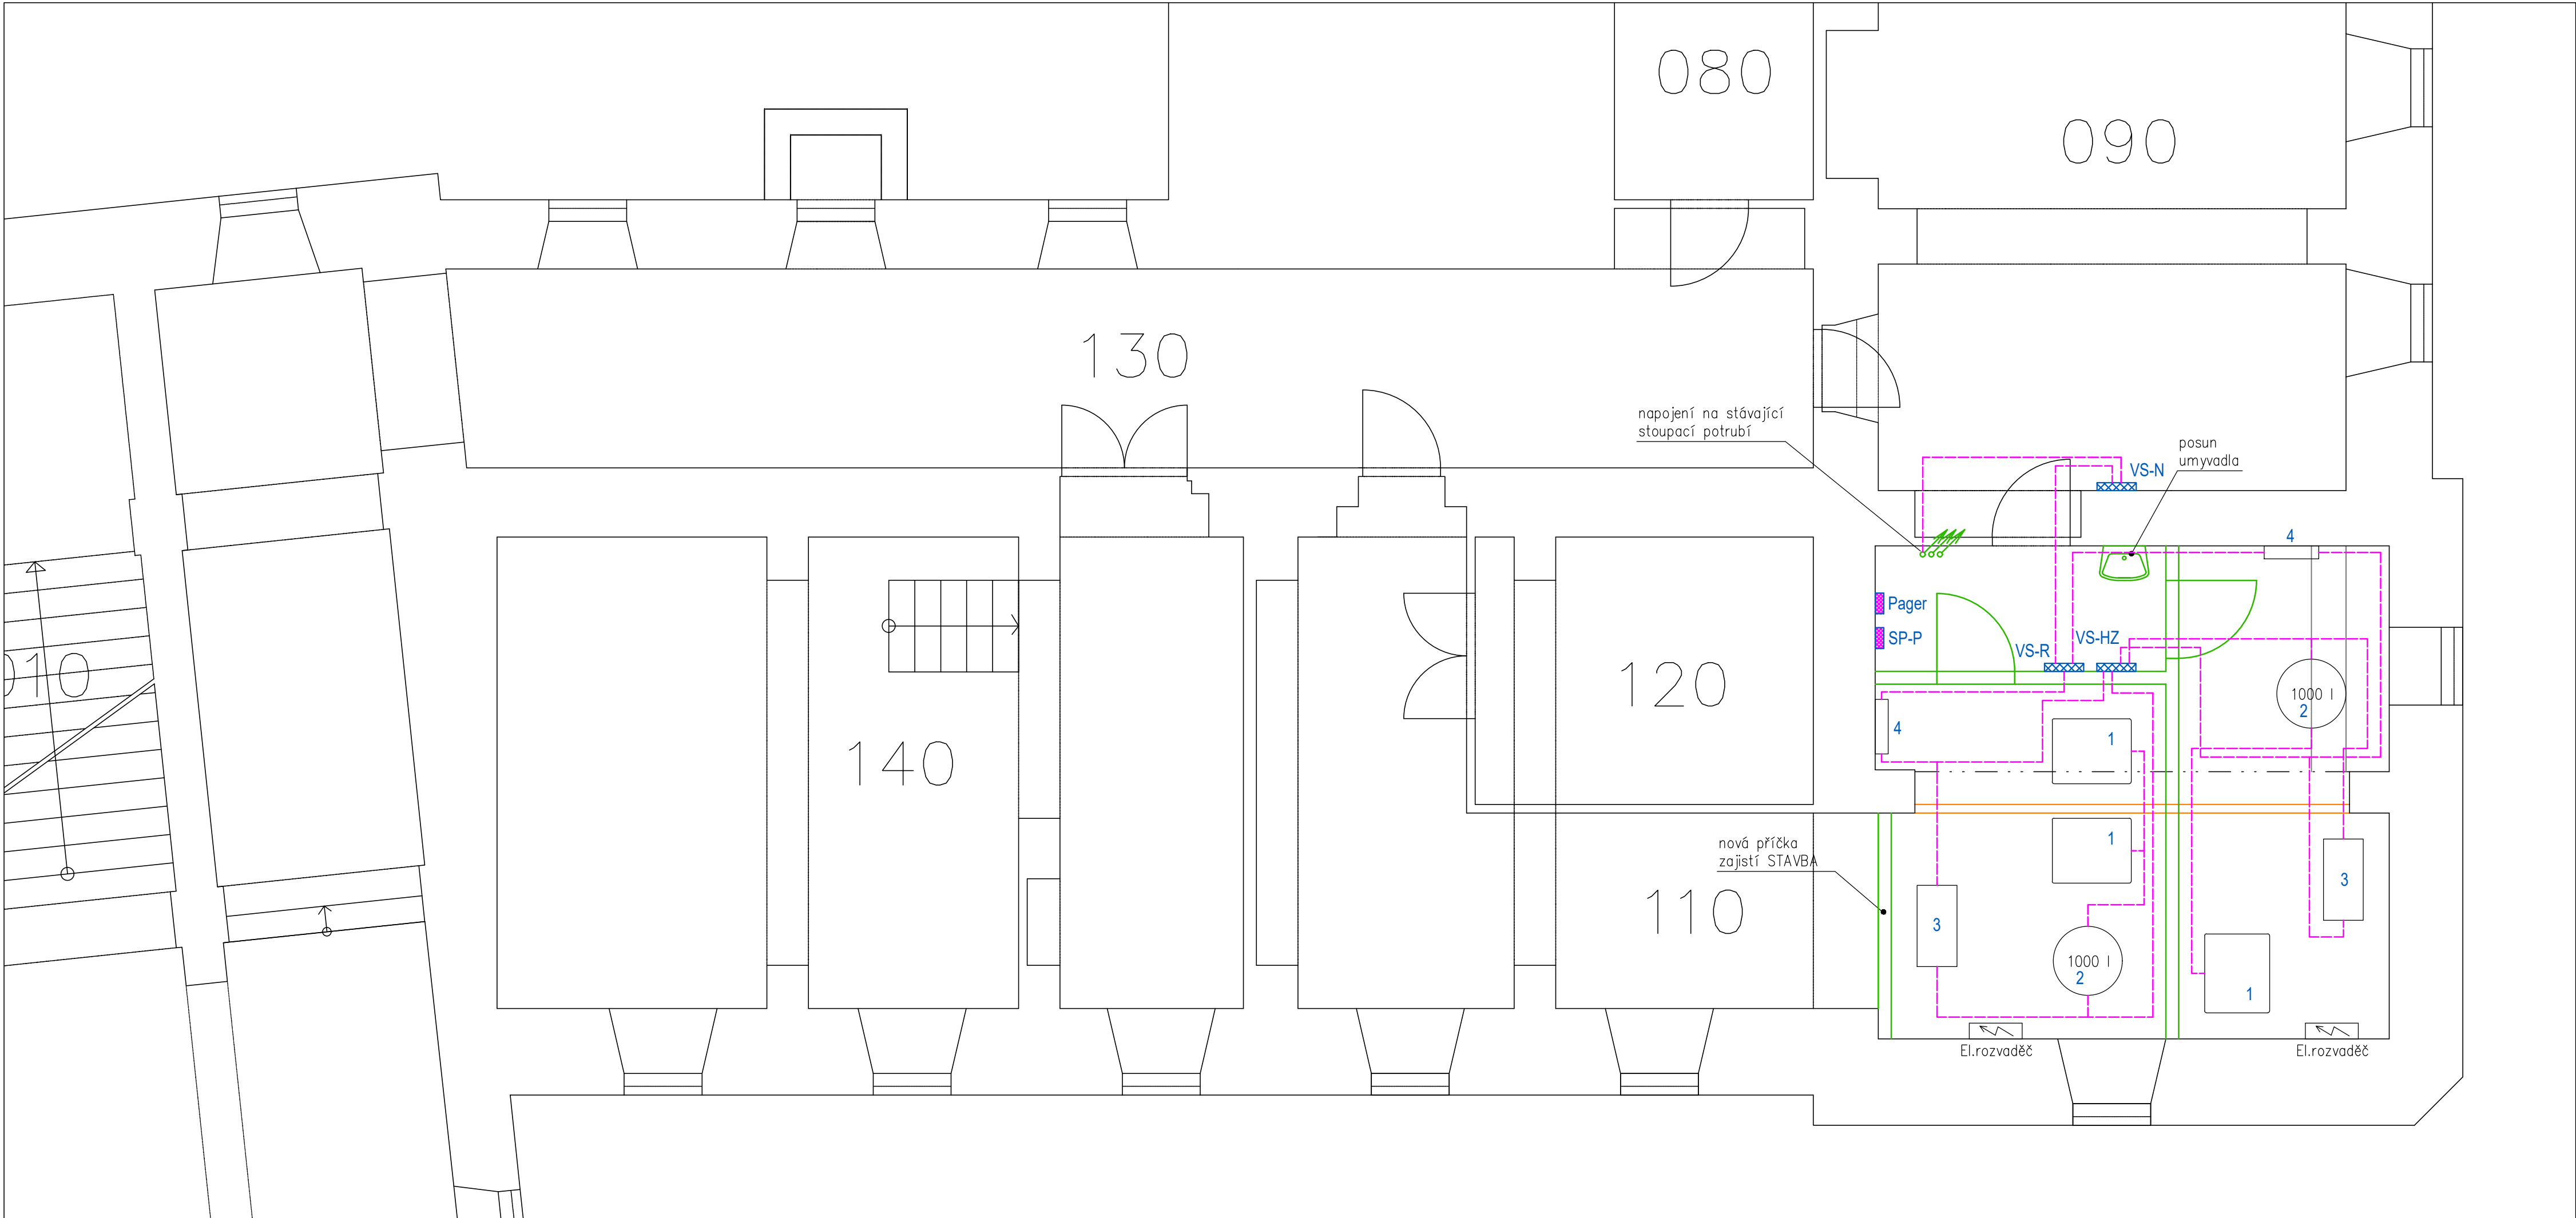

Dräger		Dräger Medical s.r.o. Na Vyběhradě 1098, 572 01 Polička, Česká republika Tel.: +420 468 001 383 E-mail: projekce@draeger.com	C. PASE
OPOVĚDĚNÍ PROJEKTU: ING. JIŘÍ BILÝŠ		VYPRACOVANÍ: ING. TOMÁŠ MACH	KONTROLOVANÍ: ING. TOMÁŠ MACH
SPRÁVA OBJEKTU: Fakultní nemocnice Olomouc Budova UZO - Palácového Kliniky zubního lékařství Oprava zdrojové stanice stlačeného vzduchu		SPRÁVČÍ: DPS FORMÁT A4 DOPRAVA: 08.4.4	LEŽENÍ: 1:50
VÝKRES: Půdorys + schéma kompressorové stanice		Č. VÝKRESU: 26700760	01
INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc		C. ZAKÁZKA: 200231	JČ: 26700760